PEOPLE HAVE PRIORITY

W&H

Gebrauchsanweisung

CE

assistina
301 plus

Inhaltsverzeichnis

Symbole 4
in der Gebrauchsanweisung 4
auf dem Medizinprodukt 5
auf der Verpackung / auf der Kartusche 6
1. Einleitung 7
2. Auspacken 9
3. Lieferumfang 10
4. Sicherheitshinweise 11
5. Beschreibung 12
Vorderseite 12
Rückseite 13
6. Inbetriebnahme 14
Erstbefüllung 17
7. Betrieb 20
Pflegeprogramm 20
Aufstecken und Abnehmen des Adapters 21
Ölpflege des Spannsystems 24
8. Reinigung 25
9. W&H Accessoires 26

10. Wartung 28
Austausch der O-Ringe 29
Erneuern des Filterpaketes 30
Austausch des Luftfilters 31
11. Service 32
Rücksendungen 32
Vorbereitung für die Rücksendung 33
12. Technische Daten 34
13. Entsorgung 35
Garantieerklärung 36
Authorisierte W&H Service Partner 37

WARNUNG!
(Falls Menschen verletzt werden können)

ACHTUNG!
(Falls eine Sache beschädigt werden kann)

Allgemeine Erläuterungen, ohne Gefahr für Mensch oder Sache

CE-Kennzeichnung

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

ACHTUNG!
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Symbole

Auf dem Medizinprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

Herstellungsdatum

CE-Kennzeichnung

MD Medizinprodukt

DataMatrix Code für Produktinformation inklusive UDI (Unique Device Identification)

Hersteller

REF Artikelnummer

SN Seriennummer

Symbole

Auf der Verpackung / auf der Kartusche

Oben

Zerbrechlich

Vor Nässe schützen

Markenzeichen »Der Grüne Punkt« – Duales System Deutschland GmbH

Markenzeichen der RESY OfW GmbH zur Kennzeichnung von recyclingfähigen Transport- und Umverpackungen aus Papier und Pappe

Storage +40°C (+104°F) Max. +5°C (+41°F) Min.

Zulässiger Temperaturbereich bei Lagerung

CE-Kennzeichnung

MD

Medizinprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

Hersteller

Rx only

Vorsicht! Nach dem Bundesrecht der USA ist der Verkauf dieses Medizinprodukts nur durch oder auf Anweisung eines Zahnarztes, eines Arztes oder eines anderen Mediziners mit einer Zulassung in dem Bundesstaat zulässig, in dem er oder sie praktiziert und dieses Medizinprodukt einsetzen oder dessen Einsatz veranlassen will

Vor Hitze schützen

Verwendbar bis

ACHTUNG!
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage

1. Einleitung

Zu Ihrer Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Patienten
Lesen Sie bitte vor erstmaliger Anwendung die Gebrauchsanweisung. Diese soll Ihnen die Handhabung Ihres Medizinprodukts erklären und eine störungsfreie, wirtschaftliche und sichere Behandlung gewährleisten.

⚠ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Zweckbestimmung
Einheit zum Reinigen der Spraykanäle und Ölen der beweglichen Teile von zahnärztlichen Übertragungsinstrumenten, Turbinen, Luftmotoren und luftbetriebenen Zahnsteinentfernungsinstrumenten.

⚠ Bestimmungswidriger Gebrauch kann das Medizinprodukt beschädigen und dadurch Risiken und Gefahren für Anwender und Dritte verursachen.

Bei der Aufbereitung der Übertragungsinstrumente mit dem Medizinprodukt erfolgt keine Desinfektion und keine Sterilisation. Nach der Reinigung der Spraykanäle und Ölpflege der Übertragungsinstrumente mit dem Medizinprodukt ist eine abschließende Desinfektion und Sterilisation erforderlich.

Qualifikation des Anwenders
Bei der Entwicklung und Auslegung der W&H Assistina sind wir von der Zielgruppe Zahnärzte/Zahnärztinnen, Dentalhygieniker/-innen und deren zahnmedizinischen Fachassistentinnen/-assistenten ausgegangen.

Einleitung

Produktion nach EU-Richtlinie
Das Medizinprodukt entspricht den Vorschriften der Verordnung (EU) 2017/745.

Verantwortlichkeit des Herstellers
Der Hersteller kann sich nur dann für die Auswirkungen auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Medizinprodukts als verantwortlich betrachten, wenn nachstehende Hinweise eingehalten werden:

> Das Medizinprodukt muss in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden.
> Das Medizinprodukt besitzt keine für den Anwender reparierbaren Teile (ausgenommen: Wechsel der O-Ringe, Kartuschen, Filter und Luftfilter).Änderungen oder Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten W&H Servicepartner durchgeführt werden (siehe Seite 37).
> Durch unerlaubtes Öffnen des Gerätes gehen Garantie- oder andere Gewährleistungsansprüche verloren.

Unsachgemäßer Gebrauch, unerlaubte Montage, Änderung oder Reparatur des Medizinprodukts, die Nichteinhaltung unserer Anweisungen oder die Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die nicht von W&H freigegeben sind, entbindet uns von jeder Garantieleistung oder anderen Ansprüchen.

Alle im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden !

2. Auspacken



Gebrauchsanweisung bereitlegen.
Weißen und grünen Trichter entnehmen.



Basisadapter abnehmen.
Assistina im Dämmkarton herausnehmen.



Karton am Steckverschluss öffnen.
Entnehmen Sie den Luftanschlussschlauch aus der Kuppel und die Erstausstattung.



Entnehmen Sie Service Öl, Reinigungslösung, Absaugfilter und das Sonderzubehör aus den Seitenfächern.

Die W&H Verpackung ist umweltfreundlich und kann über Branchen-Recycling-Gesellschaften entsorgt werden.

Wir empfehlen Ihnen jedoch die Original-Verpackung aufzubewahren.

3. Lieferumfang

> W&H Reinigungs- und Pflegegerät Assistina (REF 00030125, 00030140)
> Absaugfilter komplett
> Basis-Adapter REF 02685000
> Einfülltrichter, weiß, REF 02689300
> Einfülltrichter, grün, REF 02689400
> Luftanschlussschlauch 2 m, REF 02697000, komplett
> Erstausstattung 5 Lagen Entsorgungs-Vlies REF 02690300
> 2 Ersatz-Dichtungen REF 02680600 und
  2 Ersatz-O-Ringe REF 02695700
> Gebrauchsanweisung

4. Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise unter allen Umständen

> Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Räumen auf!
> Halten Sie das Gerät während des Pflegeprozesses geschlossen!

GHS02 ACHTUNG!

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

> P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
> P233 Behälter dicht verschlossen halten.
> P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
> P403 + P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
> P 501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

> Stellen Sie das Medizinprodukt auf eine ebene, waagrechte Oberfläche.

5. Beschreibung

Vorderseite

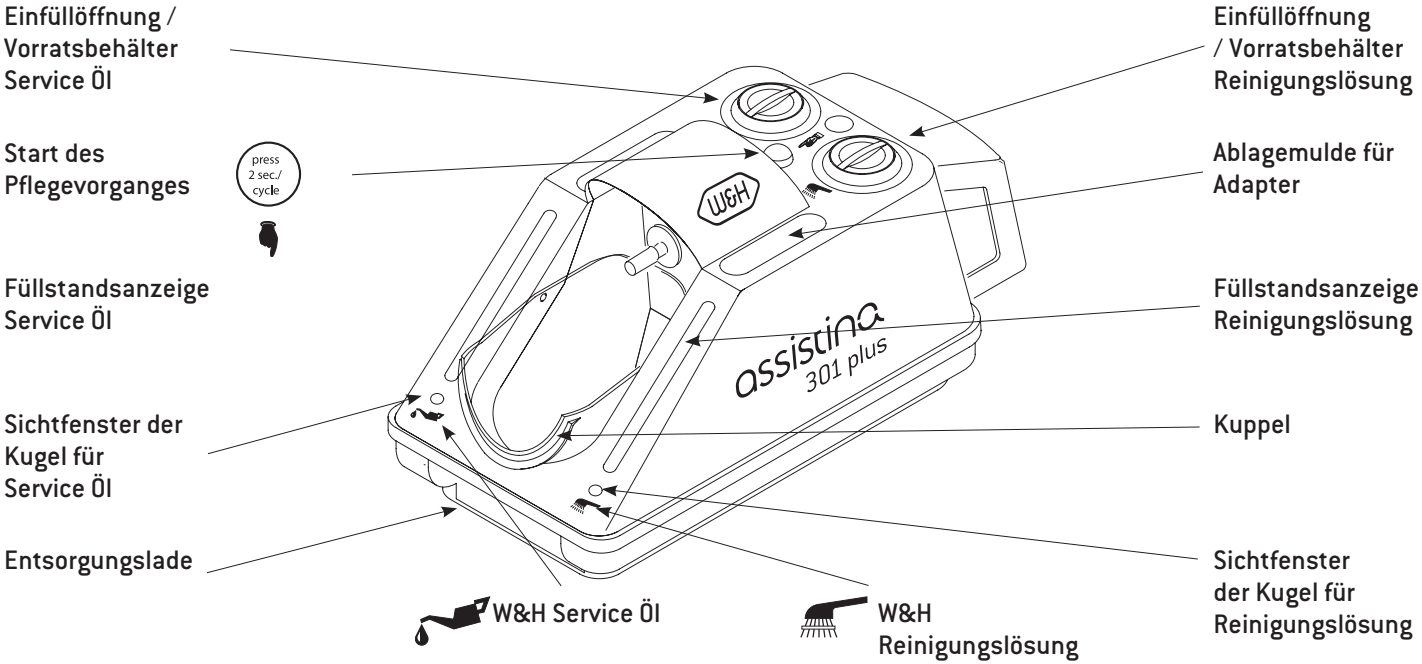

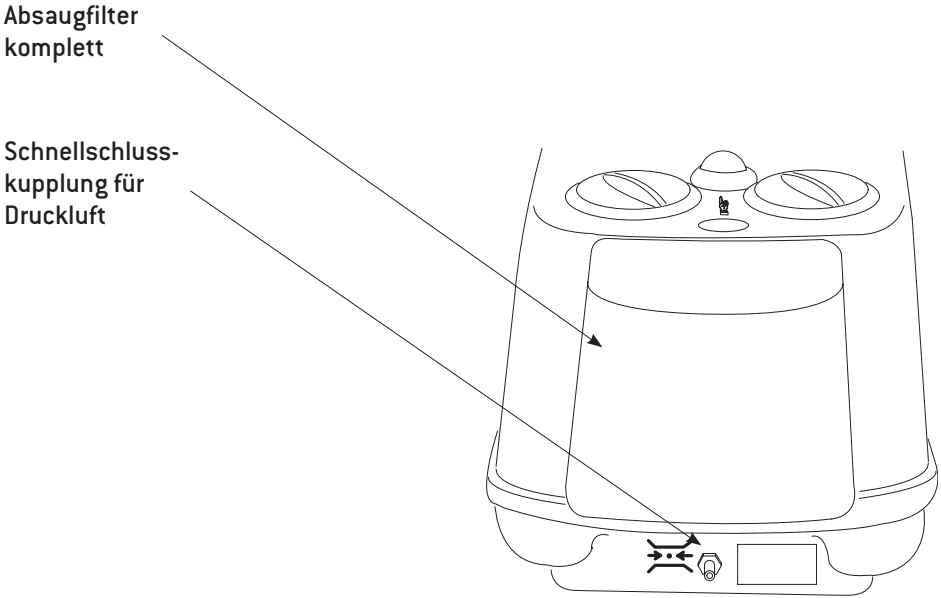
Absaugfilter komplett
Schnellschluss-kupplung für Druckluft

6. Inbetriebnahme

> Service Öl muss beim Einfüllen Zimmertemperatur haben.
> Trichter nie verwechseln (weiß zu weiß, grün zu grün) und staubfrei aufbewahren!
Kontrollieren Sie die Füllstandsanzeige!



Schrauben Sie beide Verschlüsse ab und entfernen Sie beide Transport-Dichtungen (Funktionsstörung)!

Inbetriebnahme



Schrauben Sie den Verschluss des weißen Vorratsbehälters ab.
Setzen Sie den weißen Trichter auf.

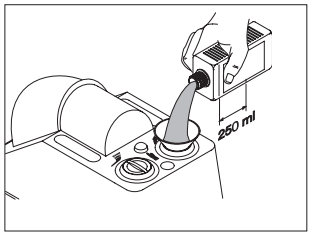

Füllen Sie 250 ml Service Öl ein.

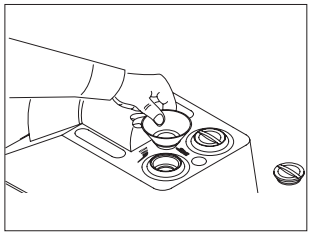

Schrauben Sie den Verschluss des grünen Vorratsbehälters ab.
Setzen Sie den grünen Trichter auf.



Füllen Sie 250 ml Reinigungslösung ein.

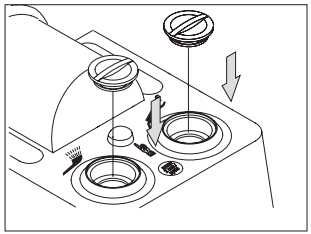

Verschließen Sie den Vorratsbehälter sowie Service Öl und Reinigungslösung.



Schieben Sie die Schnellschlusskupplung des Anschlussschlauches auf die Kupplungsdose an der Assistina. Schließen Sie dieDruckluftleitung an.



Stecken Sie den Absaugfilter dicht auf.

Der im Anschlussschlauch eingebaute Luftfilter ist nur ein Feinfilter.
Dieser kann keine ungefilterte und möglicherweise verschmutzte Kompressorluft reinigen.
Ersetzen Sie bei Verschmutzung den Feinfilter.

> Verwenden Sie nur nicht kontaminierte, ölfreie, trockene und gefilterte Druckluft gemäß ISO 7494-2.



Ziehen Sie den Tropfschutz vom Pflegeansatz ab und bewahren Sie diesen sorgfältig auf.
Schließen Sie die Kuppel.

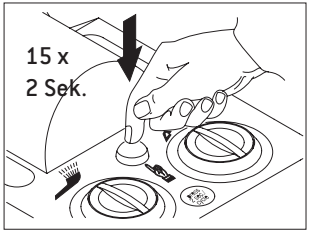

Drücken Sie den Startknopf etwa 15 mal für 2 Sekunden. Dazwischen jeweils 2 Sekunden warten.

Wenn keine Flüssigeit zu sehen ist oder in der Entsorgungslade zu finden ist, dann sind die Versorgungsleitungen noch nicht vollständig gefüllt.



Drücken Sie den Startknopf 10 mal für 2 Sekunden.

> Beim Test kein Übertragungsinstrument aufstecken bzw. keine Turbine, Luftmotor oder Zahnsteinentfernungsinstrument kuppeln!
> Nehmen Sie den Adapter ab, falls am Pflegeansatz aufgesteckt.

Inbetriebnahme



Legen Sie eine Vlieseinlage in die Entsorgungslade.



Drücken Sie den Startknopf einmal für 2 Sekunden



Schließen Sie die Kuppel und die Entsorgungslade.

Ist die Vlieseinlage benetzt, ist die Funktion gegeben.
Ansonsten wiederholen Sie den Vorgang 2 bis 3 mal.
Entsorgen Sie durchtränkte Vlieseinlagen wie Tücher für Flächendesinfektion.

Bei Betriebsstörungen (z. B. Vibrationen, ungewohnten Geräuschen, Heißwerden, Ausfall, Undichtheit) setzen Sie das Medizinprodukt sofort außer Betrieb und wenden Sie sich an einen autorisierten W&H Servicepartner.

Inbetriebnahme

Funktionsanzeige
Kontrollieren Sie laufend die Funktionsanzeige!

> Drücken Sie den Startknopf für 2 Sekunden.
Im rechten Sichtfenster erscheint eine grüne Kugel für die Reinigungslösung.
> Lassen Sie den Startknopf los.
Im linken Sichtfenster erscheint eine grüne Kugel für das Service Öl.

Nach einigen Sekunden sinken beide Kugeln wieder ab.
Der ordnungsgemäße Pflegevorgang ist an den beiden Funktionsanzeigen zu erkennen.
Ist beim Programmablauf die Kugel nicht sichtbar, liegt eine Funktionsstörung vor.

Funktionskontrolle des mechanischen Antriebes

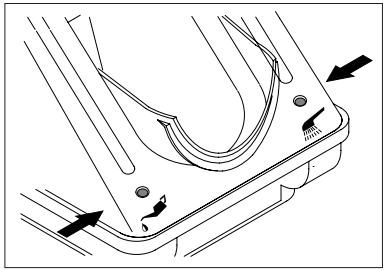

> Setzen Sie ein Übertragungs-Instrument mit eingesetztem rotierenden Instrument auf den Pflegeansatz der Assistina.
> Drücken Sie den Startknopf für 2 Sekunden.

Der Pflegezyklus beginnt, das rotierende Instrument dreht sich.
Dreht sich das rotierende Instrument nicht liegt eine Funktionsstörung vor.

> Tragen Sie Schutzkleidung, Schutzbrille, Schutzmaske und Handschuhe.
> Folgen Sie den »Hygiene und Pflege« - Anweisungen in der Gebrauchsanweisung für Überstragungsinstrumente.

Übertragungsinstrumente mit ISO-Kupplung

Das Pflegeprogramm läuft in ca. 35 Sekunden automatisch ab.
> Schwenken Sie die Kuppel nach unten.



Drücken Sie den grünen Entriegelungsknopf und ziehen Sie den Basisadapter ab. Bewahren Sie den Adapter in der Ablagemulde auf.



Drücken Sie den Startknopf 1 mal für ca. 2 Sekunden. Öffnen Sie die Kuppel nach dem Pflegevorgang.



Stecken Sie das Übertragungs-Instrument mit der Sprayaustrittsöffnung nach unten bis zum Anschlag auf den Pflegeansatz. Schließen Sie die Kuppel und die Entsorgungslade..



Drücken Sie den grünen Entriegelungsknopf des Pflegeansatzes und nehmen Sie gleichzeitig das Übertragungsinstrument ab.

Turbinen

Das Pflegeprogramm läuft in ca. 35 Sekunden automatisch ab.

> Verwenden Sie den Basisadapter REF 02685000 mit Standard 4-Loch-Anschluss.

> Schwenken Sie die Kuppel nach unten.

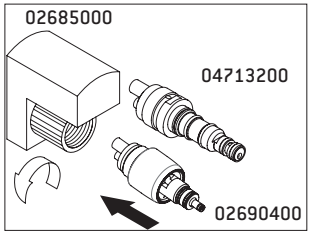

W&H Turbinen mit Schnell-kupplung:
Verschrauben Sie den Basisadapter mit dem Adapter. Adapter sind nicht zur Verwendung auf dem Turbinenschlauch geeignet.

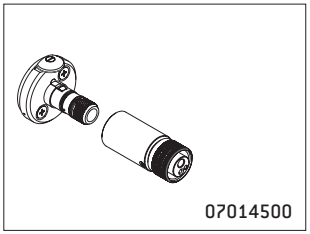

Turbinen mit
> 2- oder 3-Loch Borden-Anschluss und
> Verbindung Sprayluft zur Treibluft:
Verschrauben Sie den Basisadapter mit der Turbine. Stecken Sie den Basisadapter auf den Motoransatz.



Andere Turbinen mit Schnellkupplung:
Verschrauben Sie den Basisadapter mit der jeweiligen Schnellkupplung (z. B. Adapter 02692000, 04713200 ...).

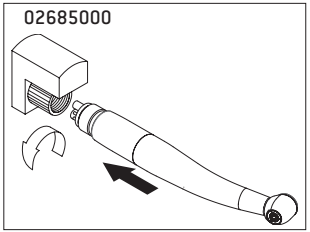

Turbinen mit Standard 4-Loch-Anschluss:
Verschrauben sie den Basisadapter mit der jeweiligen Turbine.



Stecken Sie die Adaptergruppe oder Adaptergruppe mit Turbine bis zum Anschlag auf den Pflegeansatz



Stecken Sie die Turbine mit Schnellkupplung mit der Sprayaustrittsöffnung nach unten bis zum Einrasten auf die Adaptergruppe.
Schließen Sie die Kuppel und die Entsorgungslade

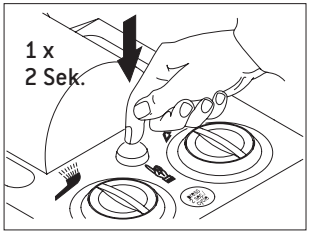

Drücken Sie den Startknopf 1 mal für ca. 2 Sekunden.
Öffnen Sie die Kuppel nach dem Pflegevorgang.

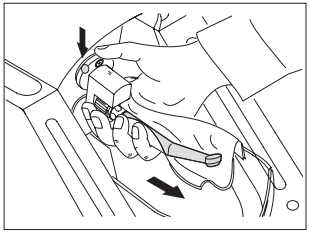

Drücken Sie den grünen Entriegelungsknopf des Pflegeansatzes und nehmen Sie gleichzeitig die Turbine von der Adaptergruppe ab.

Luftmotore und luftbetriebene Zahnsteinentfernungsinstrumente

Das Pflegeprogramm läuft in ca. 35 Sekunden automatisch ab.

> Verwenden Sie den Basisadapter REF 02685000 mit Standard 4-Loch-Anschluss.
> Stellen Sie dabei den Drehring des Luftmotors auf Rechts- oder Linkslauf (In der „Null“-Stellung erfolgt keine Pflege).
> Pflegen Sie diese wie Turbinen (siehe Seite 21).

FG-Winkelstücke

> Reinigen Sie die Spannzange mindestens einmal wöchentlich.
> Entfernen Sie das rotierende Instrument.
> Verwenden Sie den Adapter 02693000.

Tragen Sie Schutzkleidung, Schutzbrille, Schutzmaske und Handschuhe.



Schieben Sie den Adapter mit der Austrittsöffnung nach unten auf den Pflegeansatz auf.
Die Kuppel bleibt vorerst geöffnet.



Drücken Sie den Startknopf 1 mal für ca. 2 Sekunden.



Drücken Sie das Übertragungsinstrument von unten an den Adapter.
Stützen Sie das Übertragungsinstrument am Kuppelrand ab.



Drücken Sie das Übertragungsinstrument ca. 10 Sek. gegen den Adapter.
Schliessen Sie die Kuppel.
Lassen Sie die Restlaufzeit des Pflegezyklus ablaufen.

8. Reinigung

Beachten Sie Ihre lokalen und nationalen Gesetze, Richtlinien, Normen und Vorgaben für die Reinigung und Desinfektion.

> Tragen Sie Schutzkleidung, Schutzbrille, Schutzmaske und Handschuhe.

Reinigungsmittel

> Verwenden Sie nur Detergenzien, die für die Reinigung von Medizinprodukten aus Metall und Kunststoff vorgesehen sind.

W&H empfiehlt die Außenreinigung der Assistina



> einmal wöchentlich bzw. bei Bedarf.
> Verwenden Sie die W&H Reinigungslösung zur äußeren Reinigung des Gehäuses.

Reinigen der Kuppel und der Entsorgungslade



> bei Bedarf
> Drücken Sie die Kuppel leicht zusammen.
> Heben Sie die Kuppel aus der Fixierung.
> Verwenden Sie die W&H Reinigungslösung zur inneren Reinigung der Kuppel.
> Reinigen Sie die Entsorgungslade im Thermodesinfektor.

9. W&H Accessoires

Verwenden Sie nur Original W&H-Zubehör und Ersatzteile oder von W&H freigegebenes Zubehör!

Sonderzubehör

02676400	Tropfschutz zu Pflegeansatz
02679000	Adapter für abnehmbare Winkelstückköpfe
02680600	Dichtung
02685000	Basisadapter
02689300	Einfülltrichter, weiß
02689400	Einfülltrichter, grün
02690400	Adapter für alle W&H Produkte mit System Roto Quick
02691000	Adapter passend für Übertragungsinstrumente T1 CLASSIC der Firma Sirona Dental Systems
02692000	Adapter passend für Turbinen der Serie T1, T2, T3 der Firma Sirona Dental Systems
02693000	Adapter Spannsystem
05204600	Entran Winkelstück-Aufsatz
02697000	Luftanschlussschlauch 2 m
04713200	Adapter passend für Multiflex-Anschluss der Firma Kaltenbach & Voigt
07014500	Adapter Assistina Borden

W&H Accessoires

02675200	Luftfilter für Luftanschlussschlauch 02697000
02695700	O-Ring für Pflegeansatz
02670500	Filterpaket
02675910	500 ml W&H Service Öl
02680200	1000 ml W&H Reinigungslösung
02680500	Packung W&H Service Öl und W&H Reinigungslösung
02690300	Erstausstattung 5 Lagen Entsorgungs-Vlies
02694500	Entsorgungs-Vlies, Packung zu 20 Stück

10. Wartung

Wiederkehrende Prüfung der Assistina
Eine regelmäßige wiederkehrende Prüfung auf Funktion und Sicherheit ist erforderlich:

Bei jeder Anwendung:
> Kontrollieren Sie die Funktionsanzeige.

Einmal wöchentlich:
> Kontrollieren Sie die Füllstandsanzeigen.

Einmal jährlich:
> Führen Sie die Funktionskontrolle durch (Seite 19).
> Prüfen Sie den Feinfilter im Luftanschlussschlauch auf Verschmutzung.

Austausch der O-Ringe

> Ersetzen Sie beschädigte oder undichte O-Ringe sofort.
> Verwenden Sie kein scharfes Werkzeug!



Kontrollieren Sie die O-Ringe am Pflegeansatz.
Wechseln Sie die O-Ringe bei sichtbarem Defekt bzw. alle zwei Monate.
Ersetzen Sie sofort einen fehlenden O-Ring.

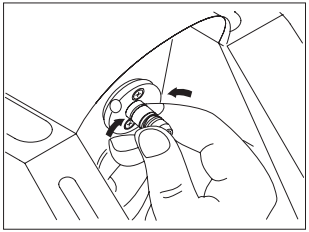

Drücken Sie den O-Ring mit Daumen und Zeigefinger fest zusammen und ziehen Sie den O-Ring ab.
Schieben Sie einen neuen O-Ring auf.

Die O-Ringe sind ohne Spezialwerkzeug austauschbar.
Fettfreie Finger erleichtern diesen Austausch.

2 Ersatz-O-Ringe
Nr. 02695700
sind hier angebracht.

Erneuern des Filterpaketes

> Greifen Sie nicht in die Lamellen des Absaugfilters (Beschädigungsgefahr)!

> Pflegen Sie nur, wenn an der W&H Assistina der Absaugfilter mit funktionstüchtigem Filterpaket angebracht ist.

> Erneuern Sie das Filterpaket im Absaugfilter nach ca. 7.000 Pflegezyklen (entspricht Verbrauch einer 500 ml Flasche W&H Service Öl).



Ziehen Sie den Absaugfilter waagrecht nach rückwärts ab



Drücken Sie mit einem geeigneten Gegenstand das Filterpaket heraus.
Entsorgen Sie dieses als Sondermüll.



Nehmen Sie das Filterpaket aus der Verpackung.
Drücken Sie das Filterpaket am Rahmen in das Filtergehäuse.
Stecken Sie den Absaugfilter wieder dicht auf.

Austausch des Luftfilters

Vor Tausch des Luftfilters die zentrale Luftversorgung abdrehen.

Den Luftfilter bei Verschmutzung oder mindestens 1x jährlich ersetzen.



Luftanschlussschlauch abnehmen.

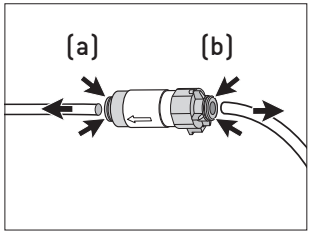

Ring (a, b) zum Luftfilter schieben und Luftanschlussschlauch abziehen..

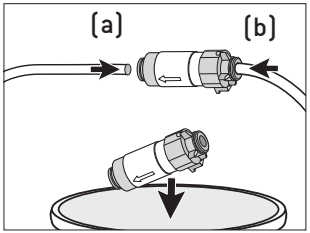

Luftfilter ersetzen und Luftanschlussschlauch (a, b) anstecken.

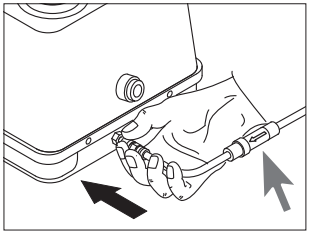

Luftanschlussschlauch anstecken.

Flussrichtung am Luftfilter beachten.

Rücksendungen

> Wenden Sie sich bei etwaigen Fragen an Ihr zuständiges Dentaldepot oder an eine unserer Servicestellen (siehe Seite 37)

Verwenden Sie zur Rücksendung die Originalverpackung!

2 Transport-Dichtungen
Nr. 02680600
sind hier angebracht.

Vorbereitung für die Rücksendung



Ziehen Sie den Absaugfilter waagrecht ab.



Kuppeln Sie den Luftanschlussschlauch ab.



Entleeren Sie die Vorratsbehälter der Reinigungslösung und des Service Öles. Die Behälter nicht gleichzeitig entleeren. Reinigungslösung und Service Öl dürfen nicht vermischt werden!

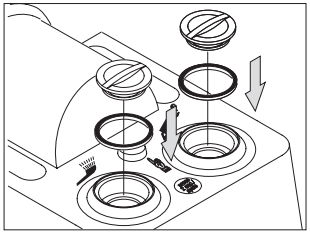

Legen Sie je eine Dichtung in jede Einfüllöffnung. Schrauben Sie jeden Verschluss zu. Montieren Sie vor dem Entleeren des ersten Behälters die Transportdichtung beim zweiten Behälter.

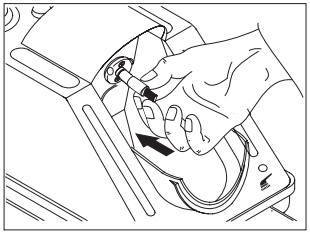

Stecken Sie den Tropfschutz Nr. 02676400 auf den Pflegeansatz auf.

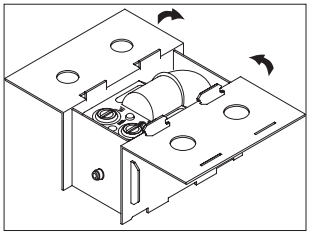

Wenn nicht mehr vorhanden: Fordern Sie über Ihr Depot eine W&H-Verpackung an oder verwenden Sie eine sichere Ersatz-Verpackung.

12. Technische Daten

Höhe:	223 mm
Breite:	190 mm
Tiefe (mit Filter):	415 mm
Gewicht:	2,70 kg
Luftverbrauch:	ca. 60 Nl/min.
Lautstärke:	63 dB (A) (in 50 cm Abstand)
Fließdruck:	4 bar bis 10 bar (Regelung durch eingebauten, automatischen Druckregler)
Füllmenge:	250 ml W&HService Öl F1, ausreichend für ca. 3.500 Pflegezyklen
	250 ml W&H Reinigungslösung, ausreichend für ca. 2.500 Pflegezyklen

Umgebungsbedingungen

Temperatur bei Transport:	0 °C bis +50 °C (+32 °F bis +122 °F)
Temperatur bei Lagerung:	+5 °C bis +40 °C (+41 °F bis +104 °F)
Temperatur bei Betrieb:	+10 °C bis +40 °C (+50 °F bis +104 °F)

13. Entsorgung

Stellen Sie sicher, dass die Teile bei der Entsorgung nicht kontaminiert sind.

Beachten Sie Ihre lokalen und nationalen Gesetze, Richtlinien, Normen und Vorgaben für die Entsorgung.

> Medizinprodukt
> Verpackung

Garantieerklärung

Dieses W&H Produkt wurde von hochqualifizierten Fachleuten mit größter Sorgfalt hergestellt. Vielfältige Prüfungen und Kontrollen garantieren eine einwandfreie Funktion. Beachten Sie bitte, dass Garantieansprüche nur bei Befolgung aller Anweisungen in der beiliegenden Gebrauchsanweisung gültig sind.

W&H haftet als Hersteller ab Kaufdatum für Material- oder Herstellungsfehler innerhalb einer Garantiezeit von 12 Monaten. Zubehör und Verbrauchsmaterialien sind von der Garantie ausgenommen.

Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder bei Reparatur durch nicht dazu von W&H ermächtigten Dritten, haften wir nicht!

Garantieansprüche sind unter Beifügung des Kaufbelegs an den Lieferanten oder an einen autorisierten W&H Servicepartner zu stellen.
Die Erbringung einer Garantieleistung verlängert weder den Garantie- noch einen etwaigen Gewährleistungszeitraum.

12 Monate Garantie

Authorisierte W&H Service Partner

Besuchen Sie W&H im Internet auf http://wh.com
Unter dem Menüpunkt »Service« finden Sie Ihren nächstgelegenen autorisierten W&H Servicepartner.

Oder scannen Sie den QR Code.

Hersteller

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t +43 6274 6236-0, f +43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com

Form Nr. 50458 ADT
Rev. 021 / 09.03.2020
Änderungen vorbehalten